2013年01月24日改訂第5版　※
2009年06月10日改訂第4版
承認番号 20600BZY00417000

歯科材料03　義歯床材料

管理医療機器　義歯床用熱可塑性レジン　JMDNコード　70825000


バイオクリルC

再使用禁止

【形状・構造及び原理】

・原材料：ポリメタクリル酸メチル成形用及び押出用材料、
法定色素

・形状
標準形状は図のとおり。

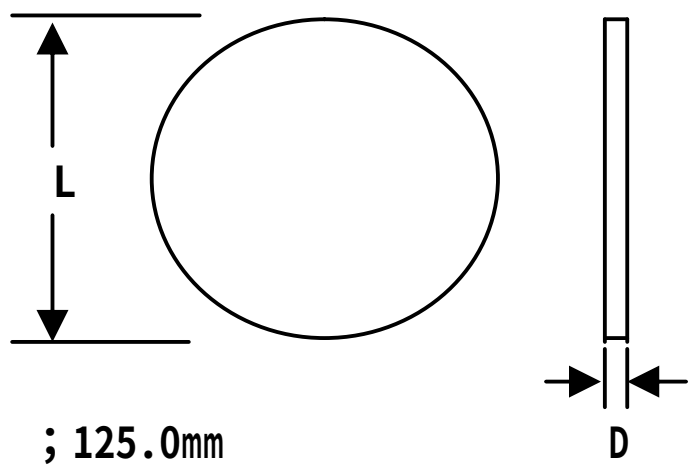

L（直径又は一辺の長さ）；125.0㎜
D（厚さ）；1.5、2.0、3.0㎜

【使用目的、効能又は効果】

・歯科用装置（リテーナー、スプリント、矯正床装置）の作製

【操作方法又は使用方法】

・加圧成型器(例　バイオスター、ショイデンタル社、ドイツ)
により加圧形成して用いる。
種類別の成型条件(バイオスター、ミニスター)は下表のとおり。
但し、コード使用はバイオスター、ミニスターＳ　scanのみ　☆
・下表成形条件はあくまでも目安です。プレートに印字されている
Code/バーコードを御使用下さい。　☆
Heat(加熱時間）、Cool(冷却時間)：単位sec

Dmm	商品番号	Code	Heat	Cool
1.5	3145／クリア	167	50	300
2.0	3147／クリア	207	70	300
3.0	3153／クリア	237	90	300
2.0	3152／オペークピンク	197	65	300

[使用方法に関連する使用上の注意]
①成型は使用する成型器の取扱説明書に従い、行ってください。
②成型の際、過加熱にご注意ください。
③本品成型の際は、通風の良い場所で行って下さい。

【使用上の注意】

1）使用注意
①本品は再使用しないこと。
②本品は【使用目的】欄に記載されている以外の目的に使用しないこと。
②本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
③万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
④本品を廃棄する場合には、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理ください。
⑤本品は稀に成形品に気泡が生じることがあります。対策として使用前に予備乾燥を行うこと。約60°の恒温層で、2〜3時間置くことをお勧めします。高温・長時間での乾燥は、本品を熱変形させますので避けてください。

2）重要な基本的注意
・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【包装】

・単品包装　10枚入り

【貯蔵・保管方法】

1）外圧がかからないように保管する。
2）加熱機器（ストーブ等）周辺には保管しないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】　※

製造販売業者　：　株式会社ロッキーマウンテンモリタ
住所　：　東京都千代田区神田駿河台2-2
御茶ノ水杏雲ビル14F
電話番号　：　03-5281-4711
FAX番号　：　03-5281-4716
製造業者　：　ショイデンタル　（ドイツ）